


Schulzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority of Drägerwerk AG, Lübeck

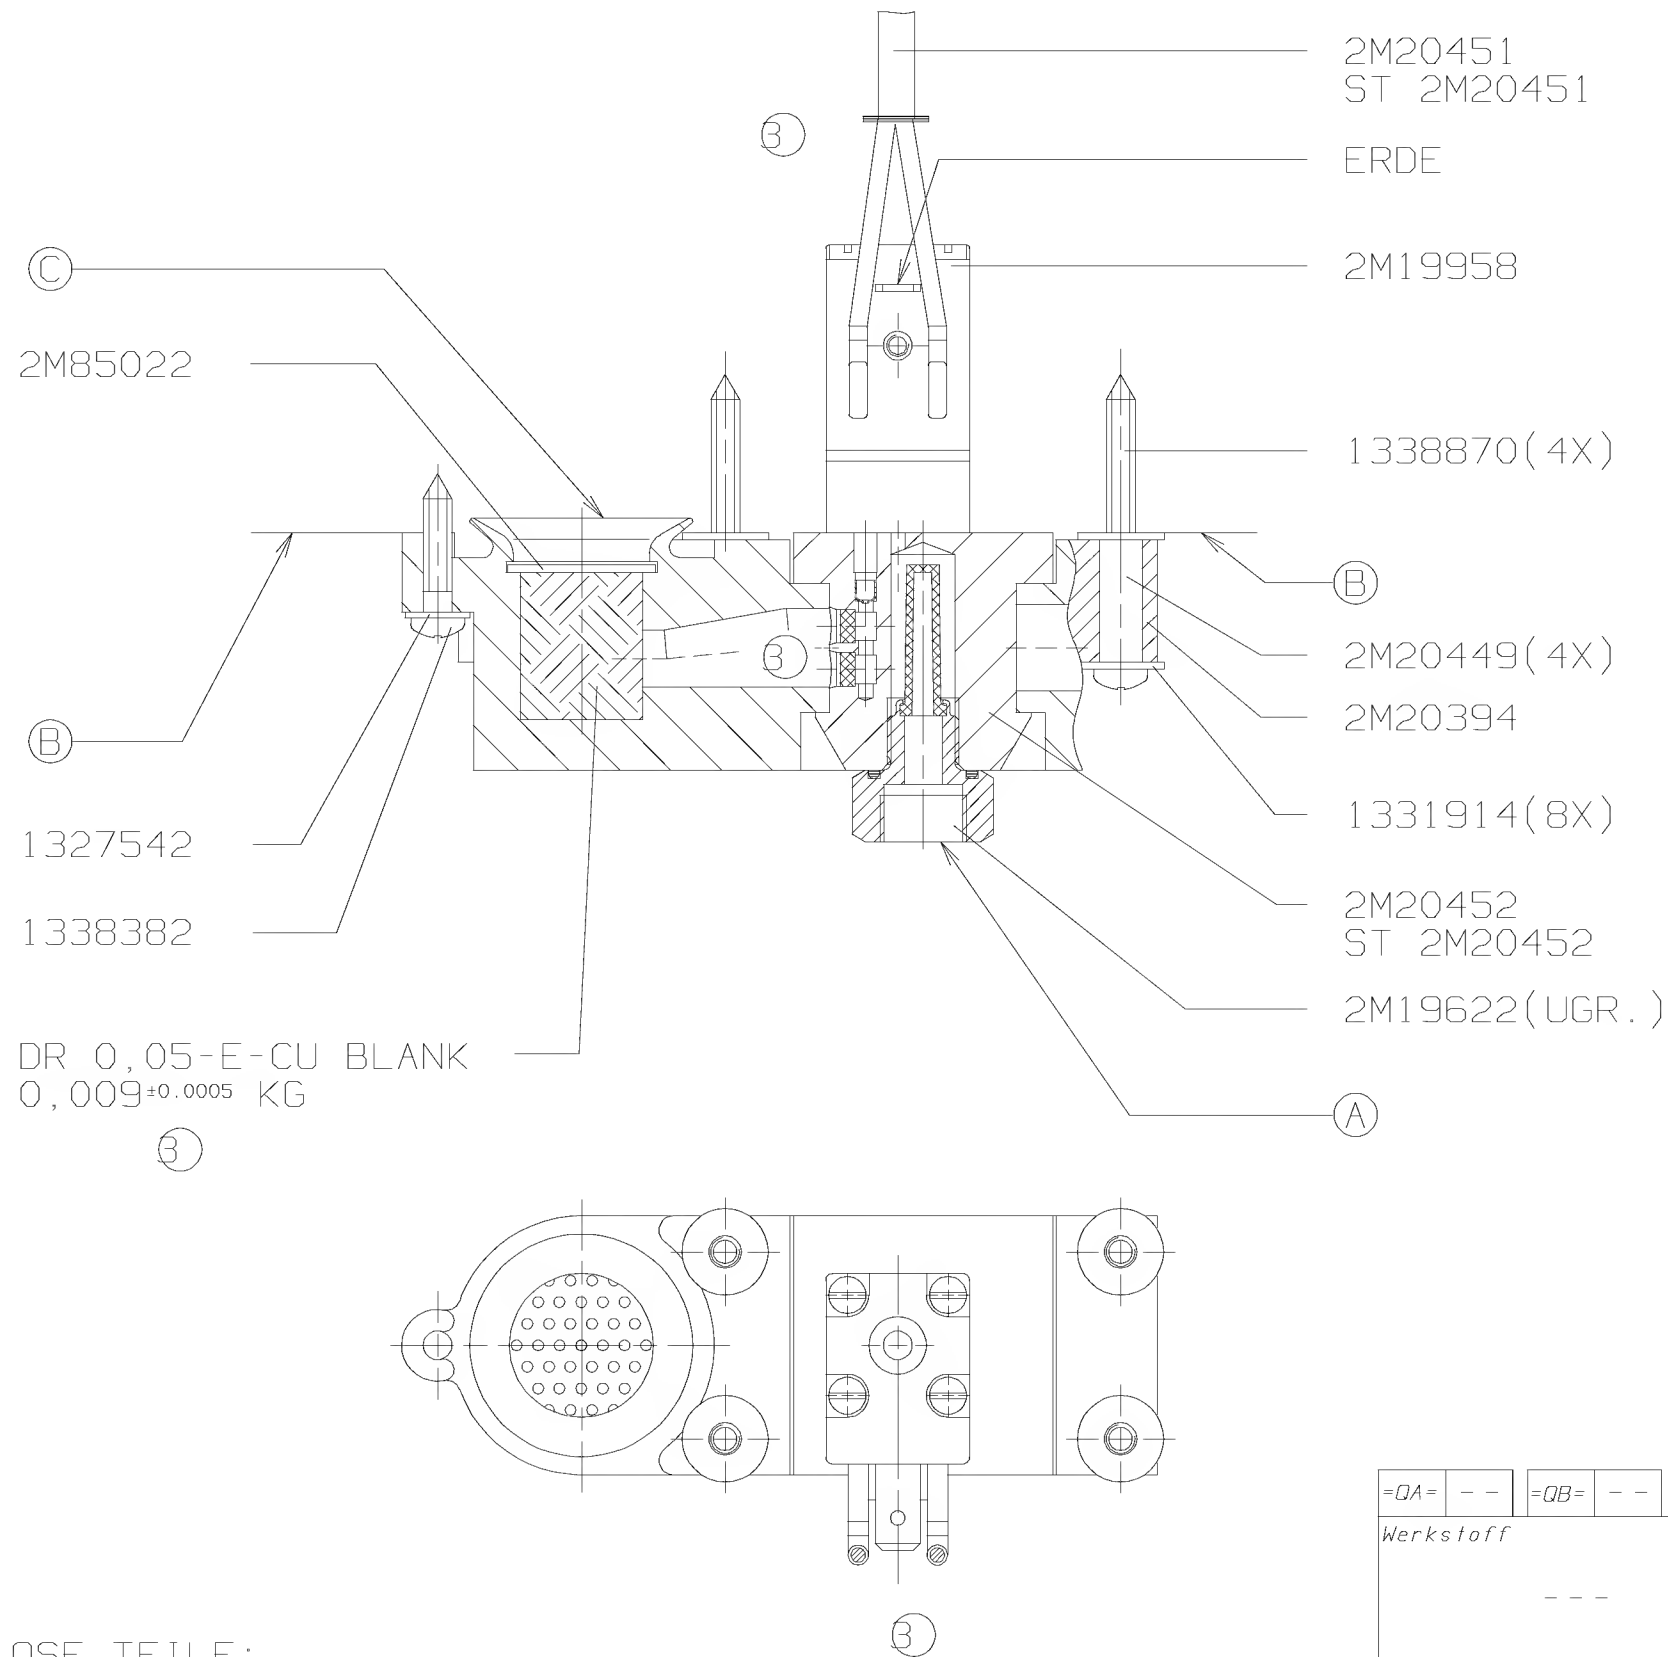

PRUEFUNG AUF DICHTIGKEIT:

DAS VENTIL MUSZ WAEHREND DER PRUEFUNG SENKRECHT STEHEN.

1. SAUERSTOFF ODER DRUCKLUFT IST UEBER DEN M12x1 O₂-NORMAN-SCHLUSZ (A) MIT 5 bar ZUZUFUEHREN.

BEI GESCHLOSSENEM MAGNETVENTIL UND ABGESPERRTER GASZUFUHR DARF DIE LECKRATE NICHT MEHR ALS 0,005(mbar L)/s =QC= BETRAGEN.

2. SAUERSTOFF ODER DRUCKLUFT IST UEBER DEN M12x1 O₂-NORMAN-SCHLUSZ (A) MIT 100 mbar ZUZUFUEHREN.

BEI GEOEFFNETEM MAGNETVENTIL (24V GLEICHSTROM AN DIE BEIDEN SENKRECHTEN FAHNEN; NICHT AN ERDE),

AUF NIVEAU (B) GEDICHTETEN TRICHTER (C) UND ABGESPERRTER GASZUFUHR DARF DIE LECKRATE NICHT MEHR ALS 1(mbar L)/s =QC= BETRAGEN.


ST 2M20399

LOSE TEILE:

1	KREUZHALTER	8404154
1	KABELBINDER	8712007
1	SCHRAUBE	1338382
1	SCHEIBE	1327542

=QA=	--	=QB=	--	=QC=	2x					
Werkstoff ---					3	4x	DARSTELLUNG UND GEWICHT GEAENDERT			
					Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen			
Masstab	Allgemein-toleranzen	Abteilung	1990	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft			Dräger	
1 : 1	---	M2	Bearb.	26.11.	CONRAD					
			Gepr.							
Benennung O ₂ -VERSORGUNG					Zeichnungs-Nr. 2M20399					
					Ersatz fuer 2M20399"2"					
INFQ					CADRA					Ersetzt durch

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authorisation by G. Lübeck
DRÄGER WERK A. G.

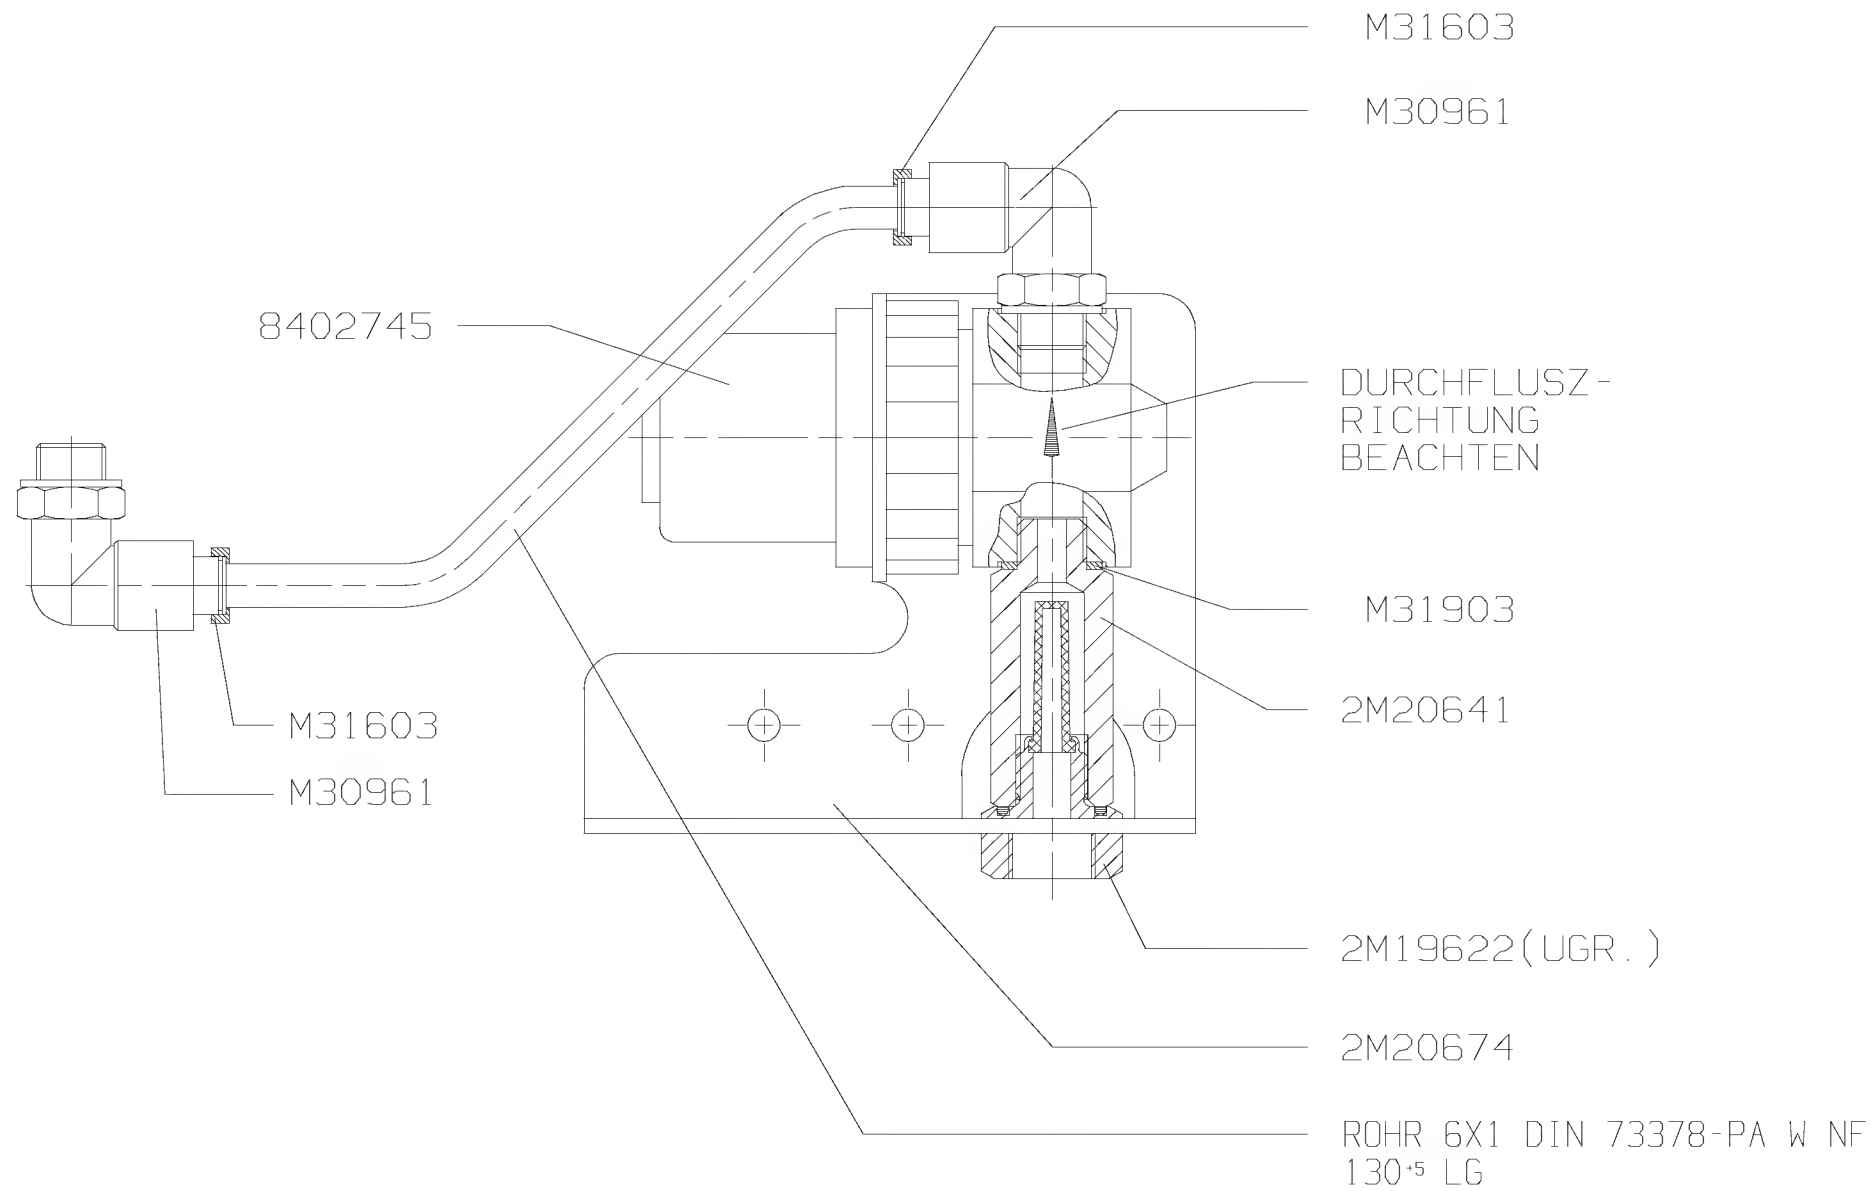


LOSE TEILE:
2x SCHRAUBE 1338382

ST2M20673


=QA=		--		=QB=		--		=QC=		--			
Werkstoff ---													
						Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen					
Maszstab		Allgemein- toleranzen		Abteilung		1992	Tag	Name		Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger			
1 : 1		---		M2		Bearb	12.02.	STI.					
						Gepr.		CONRAD					
Benennung Ruestsatz Druckregler						Zeichnungs-Nr. 2M20673							
						Ersatz fuer							
INFO		CADRA		Ersetzt durch									

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authorisation by G. Lübeck
DRÄGER WERK A. G. Lübeck

ANSICHT Z
M2:1

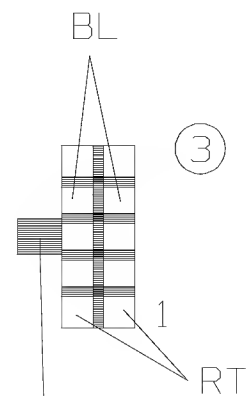

1821369
1817566(4x)

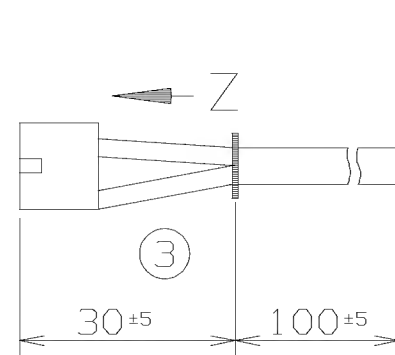

230±5

50±5

8712007(4x)

LITZE 1x034 RT LV 00952
600 LG, (2x)

LITZE 1x034 BL LV 00950
600 LG, (2x)

1817396(2x)
1817418(2x)

AUSFUEHRUNG NACH DWN 3012

100
(KONTROLLMASZ)

ST 2M20451

=QA=	--	=QB=	--	=QC=	--				
Werkstoff ---					3	2x	DARSTELLUNG GEAENDERT		
					Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen		
Maszstab	Allgemein- toleranzen		Abteilung		1991	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger	
1 : 1 (2:1)	---		M2		Bearb	22.05.	OFFEN		
					Gepr.		CONRAD		
Benennung KABELBAUM O ₂					Zeichnungs-Nr. 2M20451				
					Ersatz fuer 2M20451"2"				
INFO	CADRA		Ersetzt durch						

Dräger